

新鮮凍結血漿-LR「日赤」480の包装箱 形態変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より日本赤十字社の血液事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、日本赤十字社では新鮮凍結血漿-LR「日赤」480の包装箱につきまして、破損防止対策として底部に緩衝構造を具備した包装箱に変更することといたしましたので、次のとおりご案内申し上げます。

今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

謹白

1. 対象製剤

新鮮凍結血漿-LR「日赤」480

2. 変更点 [裏面に包装箱の写真を掲載しています]

- ・包装箱の底部に緩衝部を追加。
- ・表面窓枠の位置を変更。
- ・貯法、融解温度、有効期間の記載位置を変更。

(包装箱本体のサイズに変更はありません。)

3. 供給開始時期

新包装箱の製剤については、令和元年5月より製造を開始しており、6ヵ月間(180日間)の貯留保管後の令和元年11月以降に順次供給を開始いたします。

4. お問い合わせ

最寄りの赤十字血液センター医薬情報担当者へお願いします。

従来品




変更品



表面窓・各種表示位置の変更

緩衝部の追加

※製造番号、採血・最終有効年月日、バーコード及び写真はイメージです。

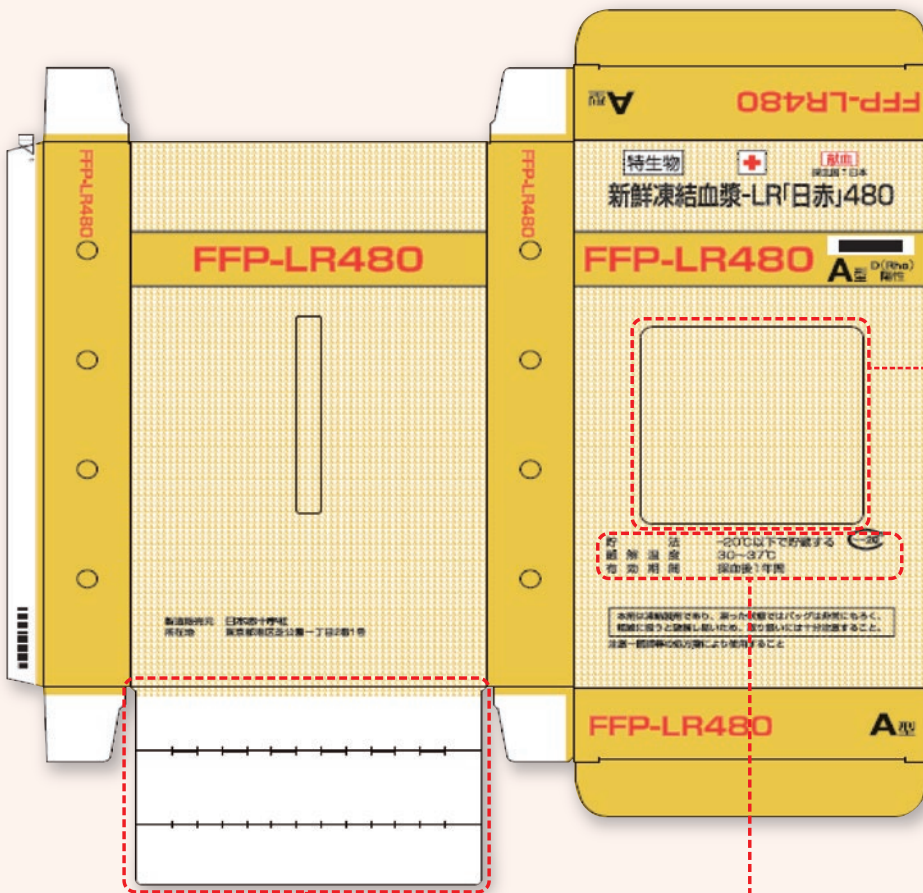

表面窓の位置
下端から
54.5mm→75mm
に変更

緩衝部用の台紙を追加

貯法・融解温度・有効期間の記載位置を変更
(従来品は表面窓上段に記載)

※包装箱サイズの変更はございません。